

お客様各位

オリエンタル酵母工業株式会社
長浜ライフサイエンスラボラトリー

検査項目に関するお知らせ



拝啓

貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、「尿生化学検査用 自動分析装置 変更のお知らせ」(2024年12月より配布開始)にてご案内しております通り、2025年4月7日(月)検査分より尿項目の分析装置を変更させていただきます。これに伴い旧装置(7180)と新装置(BM6050)でデータを比較したところ、尿中 N-アセチルグルコサミニダーゼ (NAG) において装置間で差がみられました。つきましては以下の対応を執ることで今後も安心してご利用いただける様に努めて参りますので、何卒ご了承賜ります様お願い申し上げます。

敬具

記

1. 装置比較結果

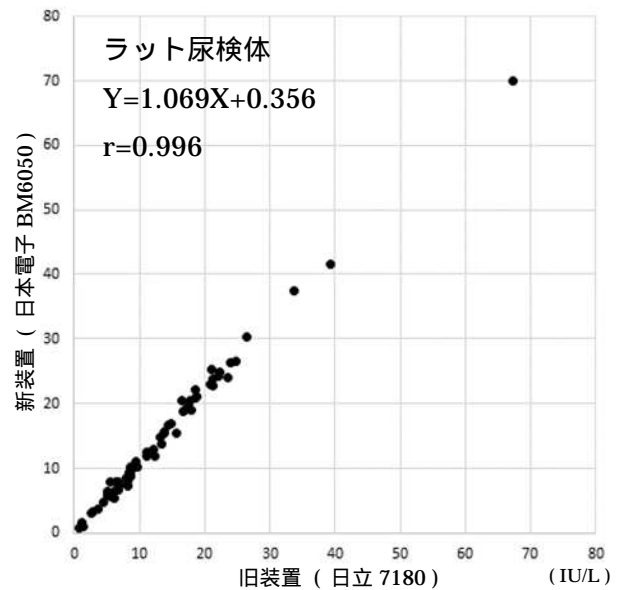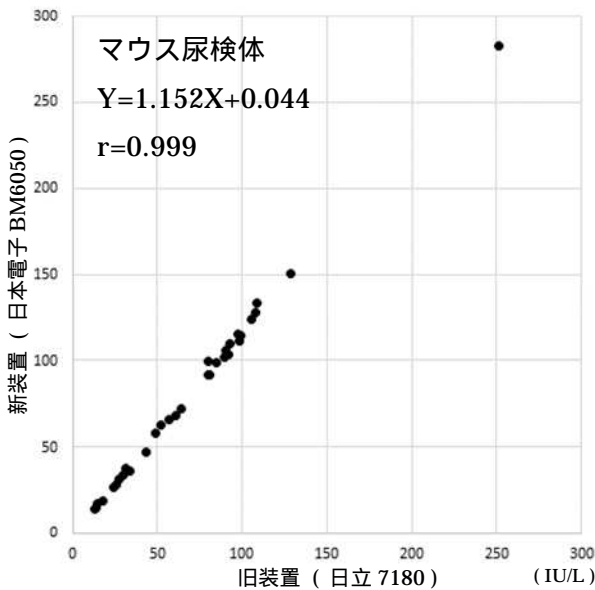

2. 対応策: ご要望がございましたら NAG につきまして、旧装置と新装置の両方で測定いたします。
依頼書の備考欄に「旧装置(日立 7180)での測定希望」とお書き添え下さい。

3. 対応期間: 2025年4月7日(月)から 2025年6月30日(月)

4. 本件に関するお問合せ先

長浜ライフサイエンスラボラトリー Tel: 0749-64-2347 Mail: n-lsl@nisshin.com

以上